

PiWeb

Reporting Plus

Table & Trend

Programm

Lens

Zeichnungs-Nr

Auftrags-Nr

Dispersion ± 0.0020

Firma


CZ IMT GmbH

Abt

SES-AP

KMG-Nr

000000



Datum

16.04.2019 08:05


Letzte 20 Messungen

► Freigabestatus ≠ Gesperrt

Prüfer

Master

				Datum	16.04.19 07:37	16.04.19 07:38	16.04.19 07:41	16.04.19 07:42	16.04.19 07:43	16.04.19 07:43	16.04.19 07:44	16.04.19 07:45	16.04.19 07:45	16.04.19 07:46	16.04.19 07:46	16.04.19 07:47	16.04.19 07:48	16.04.19 07:48	16.04.19 07:49	16.04.19 07:49	16.04.19 07:50	16.04.19 07:51	16.04.19 07:52	16.04.19 08:05
				Teile-Nr	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Auftrags-Nr	Dispersion ± 0.0001	Dispersion ± 0.0002	Dispersion ± 0.0003	Dispersion ± 0.0004	Dispersion ± 0.0005	Dispersion ± 0.0006	Dispersion ± 0.0007	Dispersion ± 0.0008	Dispersion ± 0.0009	Dispersion ± 0.0010	Dispersion ± 0.0011	Dispersion ± 0.0012	Dispersion ± 0.0013	Dispersion ± 0.0014	Dispersion ± 0.0015	Dispersion ± 0.0016	Dispersion ± 0.0017	Dispersion ± 0.0018	Dispersion ± 0.0019	Dispersion ± 0.0020
				Text																				
Name	SOLL	OT	UT																					
1. Standard Calculation																								
Measure_SphereCircle_Dia	8000.0000	0.5000	-0.5000	7999.9691	8000.0125	8000.0833	7999.9867	7999.9425	7999.7933	7999.9039	7999.9572	8000.2970	7999.6933	7999.9558	7999.5818	8000.2791	8000.6975	8000.4651	7999.4330	7999.9394	8000.0641	8000.6711	8000.5676	
Measure_SphereCircle_X	0.0000	0.0500	-0.0500	0.0001	0.0000	-0.0002	-0.0002	-0.0003	-0.0001	-0.0008	0.0001	0.0001	0.0010	-0.0019	0.0003	0.0001	0.0003	-0.0018	-0.0005	0.0005	-0.0013	0.0012	-0.0020	
Measure_SphereCircle_Z	-4000.0000	0.5000	-0.5000	-3999.9846	-4000.0062	-4000.0416	-3999.9934	-3999.9713	-3999.8966	-3999.9519	-3999.9786	-4000.1485	-3999.8466	-3999.9779	-3999.7909	-4000.1395	-4000.3488	-4000.2326	-3999.7165	-3999.9697	-4000.0320	-4000.3355	-4000.2838	
Round_XZ	0.0000	0.0020	0.0000	0.0001	0.0001	0.0002	0.0002	0.0002	0.0003	0.0003	0.0004	0.0004	0.0005	0.0005	0.0007	0.0006	0.0009	0.0007	0.0007	0.0010	0.0010	0.0010	0.0009	
2. Clamped Center XZ																								
ClampedRound_XZ	0.0000	0.0020	0.0000	0.0001	0.0001	0.0002	0.0002	0.0002	0.0003	0.0003	0.0004	0.0004	0.0005	0.0005	0.0007	0.0006	0.0009	0.0007	0.0007	0.0010	0.0010	0.0010	0.0009	
Recall_SphereCircle_XZ-Clamped_Dia	8000.0000	0.5000	-0.5000	8000.0000	8000.0000	8000.0000	8000.0000	8000.0000	8000.0000	8000.0000	8000.0000	8000.0000	8000.0000	8000.0000	8000.0000	8000.0000	8000.0001	8000.0000	8000.0000	8000.0000	8000.0000	8000.0000	8000.0000	
3. Evaluation 3D_Curve																								
Linienform_XZ	0.0000	0.0020	0.0000	0.0001	0.0005	0.0007	0.0004	0.0012	0.0012	0.0007	0.0008	0.0026	0.0012	0.0015	0.0024	0.0013	0.0013	0.0033	0.0032	0.0016	0.0019	0.0052	0.0024	
TheoLensBody_Dia_X	178.8743	0.2000	-0.2000	178.8743	178.8743	178.8743	178.8743	178.8743	178.8743	178.8743	178.8743	178.8743	178.8743	178.8743	178.8743	178.8743	178.8743	178.8743	178.8743	178.8743	178.8743	178.8743	178.8743	



PiWeb

Reporting Plus

Table & Trend

Programm

Lens

Zeichnungs-Nr

Auftrags-Nr

Dispersion ± 0.0020

Firma


Abt

KMG-Nr

CZ IMT GmbH

SES-AP

000000



Anzahl Messungen: 20

Datum

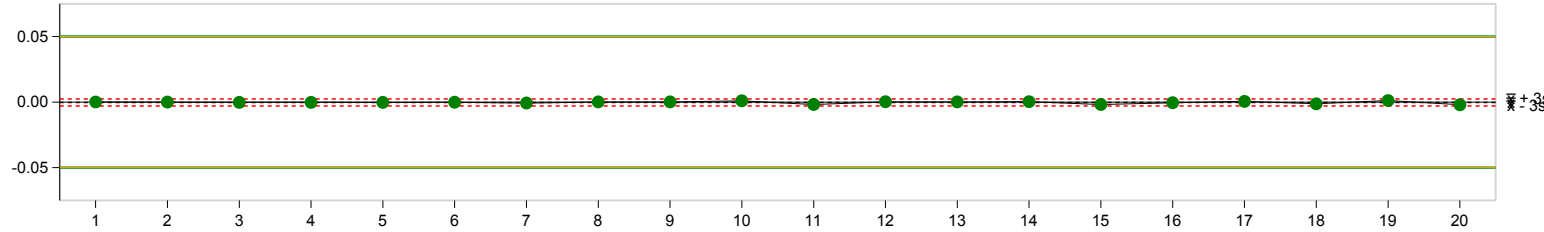
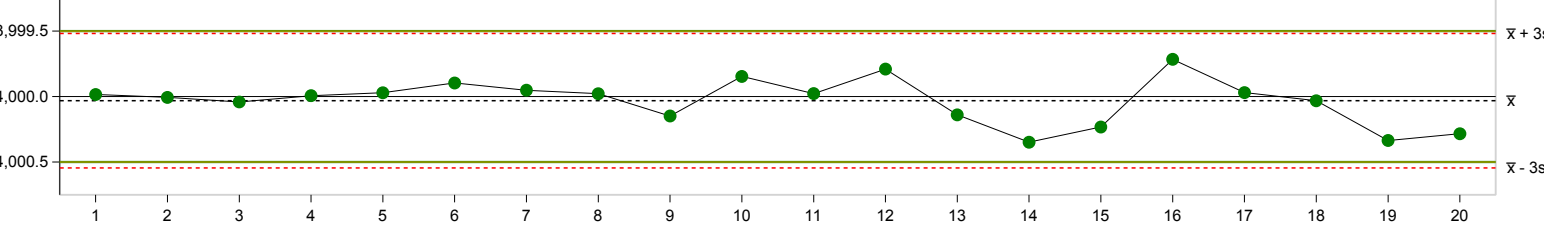
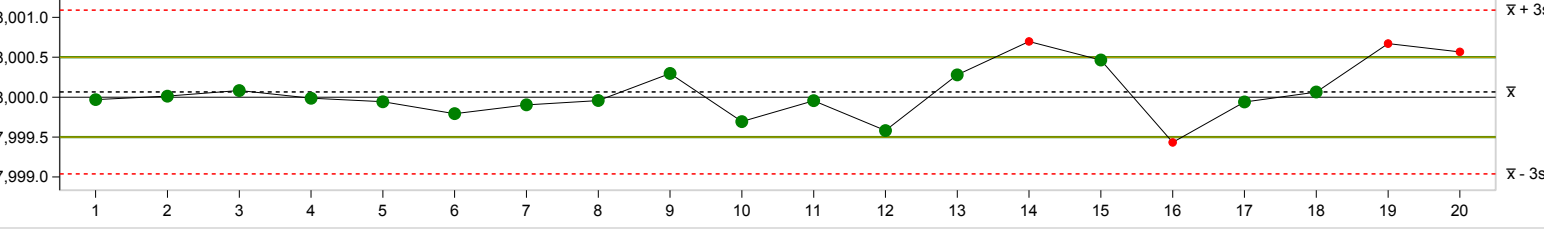
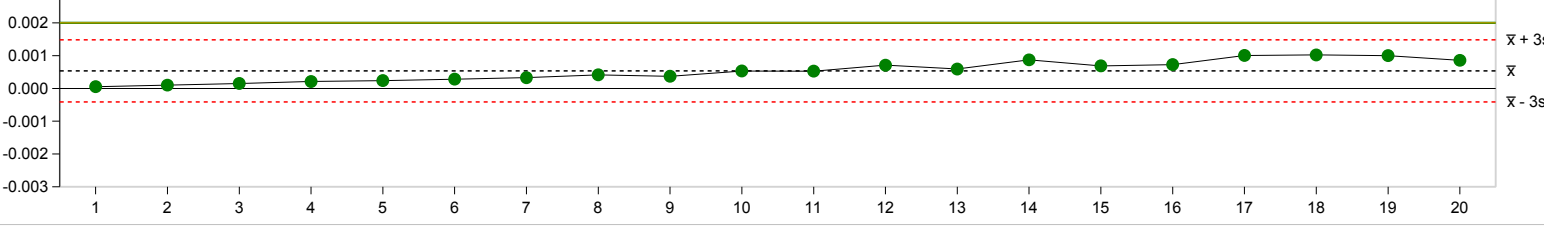
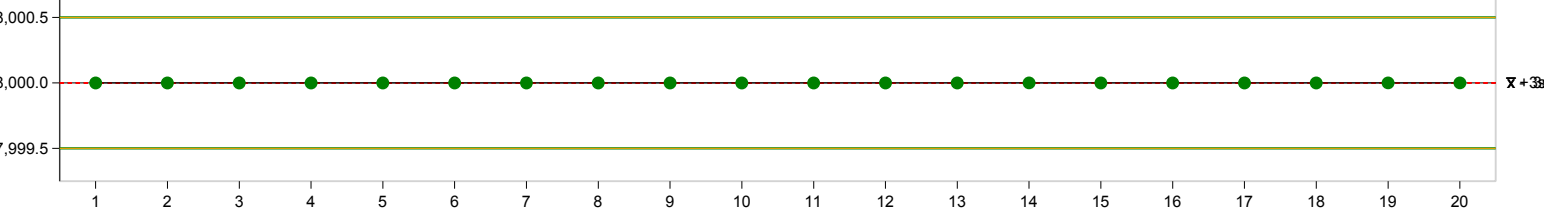
16.04.2019 08:05


Letzte 20 Messungen

Freigabestatus ≠ Gesperrt

Prüfer

Master

Merkmal	Kommentar			
Measure_SphereCircle_X				
SOLL	0.0000			
OT	0.0500	Grenzwert		
UT	-0.0500	Grenzwert		
Minimum	-0.0020	Abschätzung		
Maximum	0.0012	Cp Cg		
Spannweite	0.0032	17.88 5.61		
Mittelwert	-0.0003			
Std. Abw.	0.000891			
				
Measure_SphereCircle_Z				
SOLL	-4000.0000			
OT	0.5000	Grenzwert		
UT	-0.5000	Grenzwert		
Minimum	-4000.3488	Abschätzung		
Maximum	-3999.7165	Cp Cg		
Spannweite	0.6323	1.05 0.29		
Mittelwert	-4000.0323			
Std. Abw.	0.171046			
				
Measure_SphereCircle_Dia				
SOLL	8000.0000			
OT	0.5000	Grenzwert		
UT	-0.5000	Grenzwert		
Minimum	7999.4330	Abschätzung		
Maximum	8000.6975	Cp Cg		
Spannweite	1.2645	0.53 0.15		
Mittelwert	8000.0647			
Std. Abw.	0.342073			
				
Round_XZ				
SOLL	0.0000			
OT	0.0020	Natürliche Grenze		
UT	0.0000	Grenzwert		
Minimum	0.0001	Abschätzung		
Maximum	0.0010	Cp Cg		
Spannweite	0.0010	1.09 0.32		
Mittelwert	0.0005			
Std. Abw.	0.000316			
				
Recall_SphereCircle_XZ-Clampe...				
SOLL	8000.0000			
OT	0.5000	Grenzwert		
UT	-0.5000	Grenzwert		
Minimum	8000.0000	Abschätzung		
Maximum	8000.0001	Cp Cg		
Spannweite	0.0001	7686.75 2306.01		
Mittelwert	8000.0000			
Std. Abw.	0.000022			
				



PiWeb

Reporting Plus

Table & Trend

Programm

Lens

Zeichnungs-Nr

Auftrags-Nr

Dispersion ± 0.0020

Firma


CZ IMT GmbH

Abt

SES-AP

KMG-Nr

000000



Anzahl Messungen: 20

Datum


16.04.2019 08:05

Letzte 20 Messungen

► Freigabestatus ≠ Gesperrt

Prüfer

Master



Programm: Lens

Zeichnungs-Nr:

Anzahl Messungen:20

Lfn	Datum	Auftrags-Nr	Teile-Nr	Prüfer	KMG-Nr	Status		Freigabestatus
1	16.04.2019 07:37	Dispersion ± 0.0001	2	Master	000000	✓	<div></div>	n.def.
2	16.04.2019 07:38	Dispersion ± 0.0002	3	Master	000000	✓	<div></div>	n.def.
3	16.04.2019 07:41	Dispersion ± 0.0003	4	Master	000000	✓	<div></div>	n.def.
4	16.04.2019 07:42	Dispersion ± 0.0004	5	Master	000000	✓	<div></div>	n.def.
5	16.04.2019 07:43	Dispersion ± 0.0005	6	Master	000000	✓	<div></div>	n.def.
6	16.04.2019 07:43	Dispersion ± 0.0006	7	Master	000000	✓	<div></div>	n.def.
7	16.04.2019 07:44	Dispersion ± 0.0007	8	Master	000000	✓	<div></div>	n.def.
8	16.04.2019 07:45	Dispersion ± 0.0008	9	Master	000000	✓	<div></div>	n.def.
9	16.04.2019 07:45	Dispersion ± 0.0009	10	Master	000000	✗	<div></div>	n.def.
10	16.04.2019 07:46	Dispersion ± 0.0010	11	Master	000000	✓	<div></div>	n.def.
11	16.04.2019 07:46	Dispersion ± 0.0011	12	Master	000000	✓	<div></div>	n.def.
12	16.04.2019 07:47	Dispersion ± 0.0012	13	Master	000000	✗	<div></div>	n.def.
13	16.04.2019 07:48	Dispersion ± 0.0013	14	Master	000000	✓	<div></div>	n.def.
14	16.04.2019 07:48	Dispersion ± 0.0014	15	Master	000000	✗	<div></div>	n.def.
15	16.04.2019 07:49	Dispersion ± 0.0015	16	Master	000000	✗	<div></div>	n.def.
16	16.04.2019 07:49	Dispersion ± 0.0016	17	Master	000000	✗	<div></div>	n.def.
17	16.04.2019 07:50	Dispersion ± 0.0017	18	Master	000000	✓	<div></div>	n.def.
18	16.04.2019 07:51	Dispersion ± 0.0018	19	Master	000000	✓	<div></div>	n.def.
19	16.04.2019 07:52	Dispersion ± 0.0019	20	Master	000000	✗	<div></div>	n.def.
20	16.04.2019 08:05	Dispersion ± 0.0020	21	Master	000000	✗	<div></div>	n.def.